

Sprawa ZP/32/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawy rękawic diagnostycznych**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 587561-N-2020 z dnia 22-09-2020 r.** informujemy:

Pytanie:

1. Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe teksturowane na palcach, o długości minimalnej 290mm, o grubości na dłoni $0,09\text{mm} \pm 0,02$ i AQL 1,5?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 rękawic: rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe (1 op. 100 szt.) rozmiar: S,M,L mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość minimum na palcu 0.09mm, na dłoni minimum 0.06 (potwierdzone badaniami wytwórcy), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.5, rękawice zgodne EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671 (potwierdzone fabrycznym oznakowaniem: MDD 93/42/EEC, 2007/47/EC Class I, EN 455 (1-4), PPE Regulation 2016/425: CAT I, ASTM F 1671), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością.


Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Prosimy o dopuszczenie w poz. 2 rękawic: rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka, nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 296 mm, grubość minimum na palcu 0,14 mm, na dłoni minimum 0,09 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), mankiet rolowany, w rozmiarach S, M, L, XL, posiadające AQL 1.5, rękawice zgodne z EN 455 (1-4), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Opakowanie po 100 sztuk.

Odpowiedź: Dopuszczamy.



DYREKTOR
mgr **ANDRZEJ GRUZA**

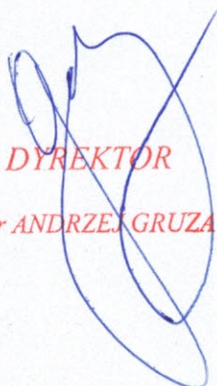

icj 291