

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 05.01.2021 r.

Sprawa ZP/47/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod numerem 775130-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. informujemy:

Pytania:

Dotyczy pakietu nr 6:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głównego analizatora biochemicznego używanego po kompleksowym przeglądzie (rok produkcji 2018)?

Odpowiedź: Tak.

2. W związku z tym, iż oferowany odczynnik do oznaczania CRP posiada szeroki zakres liniowości prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający uzna oznaczenie HsCRP za CRP o liniowości 0,2 – 480 mg/L? Jeśli tak to prosimy o wyrażenie zgody na łączne zaoferowanie odczynnika do oznaczania CRP i HsCRP.

Odpowiedź: Tak.

3. Czy w związku z tym, iż część badań w moczu wykonuje się na tym samym odczynniku jak badania w surowicy prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie ilości odczynnika pozwalającego na wykonanie ilości badań będących sumą badań wykonywanych w surowicy i moczu.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do elektrody referencyjnej? Płyny referencyjne są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody referencyjnej.

Odpowiedź: Tak.

5. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów, w którym podany jest okres gwarancji jakim objęta jest lampa fotometru?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na rozbudowanie tabel parametrów ocenianych o dodatkową kolumnę zawierającą potwierdzenie spełnienia oraz opis danego parametru?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

7. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na rozbudowanie tabeli ofertowej, w której wykonawca będzie mógł wyspecyfikować wymagane kalibratory, kontrole oraz materiały zużywalne do wyspecyfikowanych odczynników?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

8. SIWZ III 3).1. Prosimy o doprecyzowanie czy wykonawca ma przedłożyć na wezwanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych czy ulotki informacyjne dotyczące oferowanych odczynników laboratoryjnych?

Odpowiedź: Wykonawca ma przedłożyć na wezwanie karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i ulotki informacyjne dotyczące oferowanych odczynników laboratoryjnych.

9. SIWZ III 3).1. Czy na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca dla oferowanych produktów medycznych może przedstawić zamawiającemu deklarację zgodności CE, które potwierdzają, że wyrób jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych i odpowiednimi wymaganiami prawnymi?

Odpowiedź: Tak.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w formularzu cenowym zostawić wycenę tylko tych pakietów, na które składana jest oferta, pozostałe zapisy zostaną usunięte?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 13.01.2021r.?

Z uwagi na dni wolne związane z Nowym Rokiem oraz świętem w dniu 06.01.2021 r wykonawca ma skrócony czas na prawidłowe przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytania do umowy:

12. Załącznik nr 6 §5 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby powiadomienia reklamacyjne były wysyłane mailem na podany w umowie adres e-mailowy?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

13. Załącznik nr 7 §1 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na instalację analizatorów do 30 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

14. Pytanie nr 1 – dot. pakietu nr.10, pkt. 3: czy Zamawiający zezwala na zaproponowanie analizatora o wymiarach 53cm (szer) x 51,5cm (gł) x 48,2cm (wys) o wadze 34 kg?

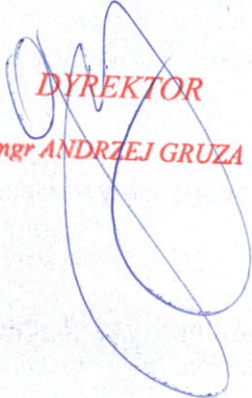
Odpowiedź: Tak.

15. Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr.10, pkt 9: czy Zamawiający zezwala na zaproponowanie analizatora, w którym zakres pomiaru HbA1c wynosi 2,4 – 22,3%?

Odpowiedź: Tak.

16. Pytanie nr 3 – dot. pakietu nr.10, pkt. 16: czy Zamawiający zezwala na zaproponowanie eluentów z terminem przydatności 3 miesiące od chwili otwarcia?

Odpowiedź: Tak.


DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA


Piotr Kabanowski