

Sprawa ZP/16/2021

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawy bielizny operacyjnej jednorazowej**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr **2021/BZP 00071327** z dnia **02 – 06 – 2021 r.** informujemy:

Pytania:

1. Dotyczy zadania 1:

Czy zamawiający odstąpi od wymogu sterylizacji, bo produkty w zadaniu 1 z definicji są niesterylizowane?

Odpowiedź: Tak.

2. Dotyczy zadania 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuście maski typu IIR?

Odpowiedź: Tak.

3. Dotyczy zadania 1 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuście maski typu IIR?

Odpowiedź: Tak.

4. Dotyczy zadania 1 poz. 4:

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości sterylizacji EO?

Odpowiedź: Tak.

5. Dotyczy zadania 1 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści ubranie w rozmiarach od S do XXXL?

Odpowiedź: Tak.

6. Dotyczy zadania 1 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny typu SMS o gramaturze min., 40 g/m kw., kolor niebieski lub zielony, na bluzie 3 duże kieszenie, obszycie dekoltu w kolorze białym?

Odpowiedź: Tak.

7. Dotyczy zadania 2 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy pakowanych w worek a`100 szt.?

Odpowiedź: Tak.

8. Dotyczy zadania 2 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie piżam w rozmiarach S – XXL?

Odpowiedź: Tak.

9. Dotyczy zadania 3 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepków wiązanych?

Odpowiedź: Tak.

10. Dotyczy zadania 3 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 80x220 cm?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy zadania 3 poz. 7:**Ze względu na opis prosimy o uszczegółowienie:**

11. Czy Zamawiający wymaga koszul : Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze M/L. Koszula z krótkim, wszytym rękawem o dł. 26 cm +/-2cm mierzona od ramienia, niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m², nieprześwitująca, niepylająca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, dł. troków przy szyi 80cm +/-2cm, dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 70 x dł. 110 cm. Opakowanie foliowe -10 szt.

Odpowiedź: Tak wymaga. Opis Zamawiającego w zakresie wymagań koszuli: 70-80 x 110-125 cm, zatem obie pozycje są aktualne. W zamówieniach Zamawiający będzie uwzględniał rozmiary.

12. Jednorazowa koszula dla pacjenta w rozmiarze XL/XXL. Koszula z krótkim wszytym rękawem o dł. 26 cm +/- 2cm mierzona od ramienia , niebieska, wykonana z oddychającej włókniny typu SMS, minimalna gramatura: 35 g/m², nieprześwitująca, niepylająca, bez zawartości lateksu. Koszula wiązana z tyłu na troki: w pasie i przy szyi pacjenta, Lamówka wraz z trokami w kolorze koszuli, długość troków przy szyi 80cm +/-2cm ,dł. troku w pasie 185 cm +/- 2 cm. Wymiary koszuli 80 x dł. 125 cm. Opakowanie foliowe-10 szt.

Odpowiedź: Tak wymaga. Opis Zamawiającego w zakresie wymagań koszuli: 70-80 x 110-125 cm, zatem obie pozycje są aktualne. W zamówieniach Zamawiający będzie uwzględniał rozmiary.

13. Dotyczy zadania 5 poz. 8:


Czy Zamawiający dopuści : Koszulę porodową SMS 38g/m² z krótkim rękawem, rozcięta z przodu i wiązana na dwie pary troków w kolorze białym. Rozmiar: M/L oraz XL/XXL. Kolor: niebieski. Opakowanie a;10 sztuk?

Odpowiedź: Tak.

14. Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- 1szt serweta z otworem 32x35cm wypełnionym folią chirurgiczną w której znajduje się otwór bez folii w kształcie półksiężyca o wysokości 15,2cm,z workiem na płyny z zaworem roz.320x180cm z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej,56g/m²
- 2 szt. serwetka włókninowa 40g, 80 x 60 cm
- 2 szt. kompres włókninowy 40g, 4-warstwowy, 10x20 cm
- 1szt, Serweta na stół Mayo o rozmiarze 145x80cm składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m². Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho >80 kPa, odporność na penetrację płynów 123 cm H₂O, zgodnie z normą PN-EN 13795, grubość folii 50 mikronów, folia piaskowana.
- 1szt serweta na stół instrumentalny, roz. 190x150cm
- 1szt podkład chłonny typu super ,masa 95 g, chłonność 2000g,roz.90x60cm

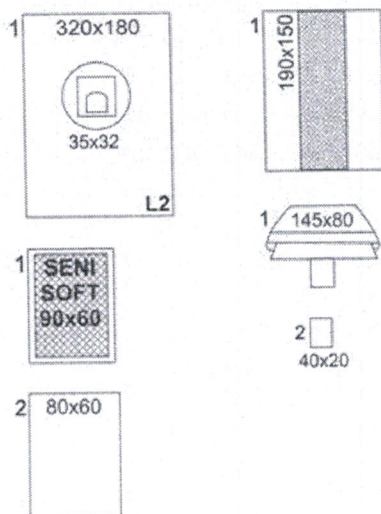

Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej 150kPa - strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia. Materiał podstawowy serwety głównej składający się z 2 warstw (folia PE oraz warstwa chłonna) o łącznej gramaturze 56g/m².

- chłonność min. 570 % wg. PN-EN ISO 9073-6
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3
- wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa , wypychanie na mokro min. 150 kPa. wg PN-EN ISO 13938-1
- czystość mikrobiologiczna max 29 cfu/dm² wg. PN-EN ISO 11737-1
- odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH₂O wg. PN-EN 20811
- pylenie max. 1,3 log₁₀ wg PN-EN ISO 9073-10.

Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Karton wewnętrzny funkcją dyspenser tj. klapka umożliwiającą wielokrotne otwieranie i zamykanie.

Odpowiedź: Tak.

15. Zadanie nr 10, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw który posiada kleszczyki plastikowe 13 cm miejsce metalowych oraz serwetę foliowaną do owinięcia zestawu w rozmiarze 75 x 75 cm o gramaturze 42g/m²? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

16. Zadanie nr 10, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw który posiada serwetę włókninową w rozmiarze 60 x 50 cm oraz narzędzia metalowe z naniesionym znakiem CE (nie wygrawerowanym)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

17. Zadanie nr 10, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, który posiada 6 szt. Serwet kompresowych włókninowych białych, chłonnych, rozm. 30x30cm ? Pozostałe parametry zestawu zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak.

18. Zadanie nr 10, poz. 11,12:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kieszeń wykonaną z folii o grubości 80 µm (+-3)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

19. Pytanie dot. terminu składania ofert:

Czy ze względu na wymóg złożenia wraz z ofertą próbek oferowanych wyrobów Zamawiający zgodzi się na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.06.2021 r, aby umożliwić Wykonawcom złożenie kompletnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 15.06.2021 r., godzina bez zmian.

20. Pytania dot. wzoru umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

21. Pakiet 4, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 60 x 80cm?

Odpowiedź: Tak.

22. Pakiet 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający jednorazowego użytku; warstwy zewnętrzne wykonane z włókniny polipropylenowej 25 g/m² w kolorach zielonym i niebieskim, warstwa wewnętrzna z poliestru 77g/m², z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; szwy ultradźwiękowe; niepalny. Rozmiar 150 x 210 cm.

Odpowiedź: Tak.

23. Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm. Gramatura materiału 5g/m², wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPA. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik.

Odpowiedź: Nie.

24. Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw osłon na ramię C, składający się z:

- osłony górnej 100 x 160cm,
- osłony dolnej 80 x150 cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej 3 x 100cm

Osłony wykonane z transparentnej folii polietylenowej z elastyczną gumką stabilizującą osłonę.

Odpowiedź: Tak.

25. Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o składzie:

- ⌚ 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- ⌚ 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- ⌚ 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- ⌚ 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- ⌚ 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- ⌚ 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, niepiaskowana, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie transportowe – system podwójnego zabezpieczenia (worek foliowy + karton zewnętrzny).

Odpowiedź: Tak.

26. Pakiet 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów perforowanych co 38cm?

Odpowiedź: Tak.

27. Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

- ⌚ 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- ⌚ 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- ⌚ 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- ⌚ 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- ⌚ 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- ⌚ 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- ⌚ 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m². Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Tak.

28. Pakiet 10, pozycja 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Tak.

29. Pakiet 10, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia p/p, o składzie:

- 1 szt. serweta serweta 2-warstwowa min. 80cm x 60cm o gramaturze min. 35 g/m², z przylepnym otworem centralnym o śr. 7cm
- 7 szt. kompresy gazowe 7,5x7,5cm,17-nitkowe,8-warstwowe
- 1 szt. kleszczyki z niebieskim oznaczeniem kolorystycznym na jednym uchu, reszta parametrów zgodnie z SWZ
- 1 szt serweta 2-warstwowa (włóknina PP + folia PE) min. 50cm x 50cm o gramaturze min.39 g/m², niebieska, do owinięcia zestawu

Odpowiedź: Tak.

30. Pakiet 10, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw zabiegowy w składzie:

- 10 szt. kompresy gazowe roz.7,5x7,5cm,8W
- 2 szt. kompresy włókninowe roz.10 x 10 cm (zamiast 7,5x7,5cm),40g/m², z nacięciem „Y”
- 1 szt. serweta włókninowa35g/m², roz.60x40cm do zawinięcia zestawu
- 2 szt. serweta foliowana 40 g/m² (zamiast 43g/m²), roz.45x45cm
- 1 szt. miseczka przezroczysta poj. 120 ml (zamiast kubek plastikowy okrągły 125ml, przezroczysty)
- 1 szt. igłotrzymacz mayo-hegar metalowy dł. 15cm (zamiast pean prosty, metalowy, 14cm)
- 1 szt. pean prosty metalowy dł. 18cm (zamiast kocher 18cm z ząbkami, metalowy)
- 1 szt. nożyczki metalowe proste ostro-tępe dł. 15cm (zamiast nożyczki zagięte, mayo, tępo-tępe, 15cm, metalowe)
- 1 szt. penseta anatomiczna 14cm, metalowa

Narzędzia metalowe, jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej.

Wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 13485.

Zestaw zapakowany w opakowanie folia-papier, oznakowany kierunek otwierania bez wycięcia na kciuk – zgrzew prosty. Na wierzchu centralna etykieta + dwie samoprzylepne etykiety z nazwą producenta, Lot, datą ważności, do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Tak.

31. Pakiet 10, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu w składzie:

- 2 szt. Serweta gazowa 90x75cm 4W, tasiemka
- 20 szt. Kompresy gazowe 10x10cm, 17N, 8-warstwowe, gramatura 1 szt. 1,9g (zamiast 2,11g)
- 1 szt. Podkład chłonny typu Seni Soft 90x60cm
- 1 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 80x 60cm
- 6 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 25x20cm
- 1 szt. Zacisk na pępowinę
- 1 szt. Fartuch chirurgiczny przeznaczony do długich i mokrych zabiegów z włókniny SMS (polipropylenowej) o masie powierzchniowej 35g/m². Wzmocnienie do 25cm nad dolną krawędzią, rękawy do łokci z nieprzemakalnymi wstawkami o masie 40g/m². Rękaw prosty, nie krępujący ruchów, wykończony białym, dzianym, niepylącym, poliestrowym, bezszwowym mankietem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rozm. XL
- 1 szt. podkład chłonny typu Seni Soft 60 x 60cm
- 1 szt. serweta 2-warstwowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze min.56g/m² rozm. min 150x90 cm

Odpowiedź: Tak.

32. Wymogi dla pakietu 10 - Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry dla laminatu dwuwarstwowego: polipropylenowo-polietylenowy, wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 56N i mokro min.50N.Odporność na przenikanie cieczy min.120cm H₂O.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

33. Pakiet 10, pozycja 5 - Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z celulozy, o gramaturze 56g/m², rozmiar 40 x 40cm. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

34. Pakiet 10, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Tak.

35. Pakiet 10, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Tak.

36. Pakiet 10, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło podfoliowane o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Tak.

37. Pakiet 10, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń wykonaną z folii o grubości 0,065mm? Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Tak.

38. Pakiet 10, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową wykonaną z folii o grubości 0,065mm, w rozmiarze 40 x 30 cm? Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Tak.

39. Pakiet 10, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę o gramaturze 40g/m², w rozmiarze 75 x 90 cm, z otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Nie.

40. Pakiet 10, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę o gramaturze 40g/m², w rozmiarze 75 x 90 cm, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6x8 cm?

Odpowiedź: Tak.

41. Zadanie 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 9,5 cm x 17,5 cm?

Odpowiedź: Tak.

42. Zadanie 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści maski o barierowości minimum 98%?

Odpowiedź: Tak.

43. Zadanie 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści maski w rozmiarze 9,5 cm x 17,5 cm?

Odpowiedź: Tak.

44. Zadanie 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści maski o barierowości minimum 98%?

Odpowiedź: Tak.

45. Zadanie 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści jednorazowe wysokochłonne, oddychające prześcieradło ochronne na stół operacyjny z możliwością udźwigu do 150 kg, nieprzemakalne. Prześcieradło 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej, warstwa zewnętrzna od strony pacjenta wykonana z włókniny oddychającej. Wymiar całkowity 225 cm x 101 cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm) zawiera substancję pochłaniającą płyny, pikowana, dzięki czemu podkład się nie marszczy, nadaje się do długotrwałych zabiegów operacyjnych. Bielony bez użycia chloru. Warstwy wolne od ftalanów, warstwa spodnia pełnobarierowa. Możliwość sterylizacji EO. Chłonność całkowita min 4500 ml (potwierdzone badaniem laboratoryjnym).

Odpowiedź: Tak.

46. Zadanie 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a'1 sztuka?

Odpowiedź: Tak.

47. Zadanie 1 poz. 4: Czy Zamawiający wymaga aby prześcieradło pakowane było a'1 sztuka ze względu na użycie prześcieradła na salach operacyjnych?

Odpowiedź: Nie.

48. Zadanie 1 poz. 5: Czy zamawiający dopuści komplety w rozmiarach S – XXL?

Odpowiedź: Nie.

49. Zadanie 1 poz. 5: Czy zamawiający dopuści komplety w rozmiarach S – XXXL?

Odpowiedź: Tak.

50. Zadanie 1 poz. 5: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?

Odpowiedź: Tak.

51. Zadanie 1 poz. 5: Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?

Odpowiedź: Tak.

52. Zadanie 1 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści ubranie z trzema kieszeniami, w którym górna kieszeń ma szerokość 14 cm?

Odpowiedź: Tak.

53. Zadanie 1 poz. 6: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletów chirurgicznych dopuszczonych do stosowania na bloku operacyjnym zgodnych z wymaganiami normy EN 13795?

Odpowiedź: Tak.

54. Zadanie 1 poz. 6: Czy Zamawiający oczekuje w celu potwierdzenie spełnienia wymogów normy EN 13795 przedstawienia raportu z badania gotowego produktu?

Odpowiedź: Tak.

55. Zadanie 1 poz. 7: Czy zamawiający dopuści fartuch medyczny podfoliowany na całej powierzchni PP +PE, gramatura 40g/m² ze ściągaczem poliestrowym min 5 cm?

Odpowiedź: Tak.

56. Zadanie 1 poz. 7: Czy zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10 sztuk?

Odpowiedź: Tak.

57. Zadanie 1 poz. 7: Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

58. Zadanie 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane w folię?

Odpowiedź: Tak.

59. Zadanie 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 30 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

60. Zadanie 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski lub zielony?

Odpowiedź: Tak.

61. Zadanie 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS o gramaturze min. 35g/m²?

Odpowiedź: Tak.

62. Zadanie 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści 3 kieszenie (jedna o góry, dwie na dole)?

Odpowiedź: Tak.

63. Zadanie 2 poz. Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści spodnie wiązane na troki?

Odpowiedź: Tak.

64. Zadanie 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź: Tak.

65. Zadanie 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści w zamian za „Wyrób bezlateksowy - zaznaczone na opakowaniu jednostkowym”- oświadczenie producenta potwierdzające, że wyrób jest bezlateksowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

66. Zadanie 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści rozmiary S, M, L, XL, XXL ?

Odpowiedź: Tak.

67. Zadanie 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź: Tak.

68. Zadanie 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Tak dla rozmiarów L i XL.

69. Zadanie 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści Fartuch wizytacyjny ze ściągaczem o szer. min 5 cm?

Odpowiedź: Tak.

70. Zadanie 2 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Tak.

71. ZADANIE NR 8: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego w kolorze zielonym wykonanego z laminatu 2- warstwowego PP-PE o min. gramaturze 55 g/m² i grubości folii min. 60 µm o następującym składzie:

1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)

1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm (laminat 2- warstwowo PP-PE o całkowitej gramaturze 90

g/m², grubość folii min. 60 µm, kolor zielony)

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm bez organizatorów przewodów i portów do ssaka (ułożenie płasko na stole)

1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

2 ręczniki celulozowe 33 x 30 cm

Parametry techniczne:

Odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 130 kPa

Odporność na penetrację płynów min. 150 cm H₂O

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

72. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1:

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy, tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

73. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4:

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia oraz zasady prosimy o dodanie do umowy w zakresie § 5 zapisu:

„Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamiarze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w dowolnym momencie po upływie terminu dostawy częściowej. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadł na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu).”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

74. Dotyczy wzoru umowy

W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ postanowienia, przewidującego zmianę (wzrost) ceny netto w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny.

„Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT.”

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami.

Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie


zamówienia publicznego, przy obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT np. o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty.

W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p.

W związku z powyższym, prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny netto w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 15.06.2021 r. do godz. 10.00.


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowie Świętokrzyskim
Dyrektor ds. Lecznictwa
dr in med Adam Karolik

