

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.10.2022 r.

Sprawa ZP/31/2022

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*zakup i dostawy odzieży ochronnej dla personelu, zestawów obłożeń oraz produktów do dezynfekcji i sterylizacji*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00370513/01 z dnia 29.09.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie nr 1) ZADANIE NR 3 Poz. Nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Zestawy opakowane w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz z 2 etykietami samoprzylepnymi do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2) Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia przewodowego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)
- 2 x serweta wzmocniona przylepna 90 x 75 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm niebieskie
- 10 x kompres z gazy 10 x 10 cm

Odpowiedź: wymagana serweta z otworem

Pytanie nr 3) Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do porodu o następującym składzie:

- 1 serweta (owinięcie pakietu) 120 x 95 cm- laminat 2-warstwowy PP-PE o min. gramaturze 55 g.m2
- 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
- 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm
- 1 nożyczki chirurgiczne proste tępo tępo 14,5 cm
- 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm
- 4 rękawiczki nitrylowe L
- 1 gruszka gumowa 60 ml
- 1 x torebka papierowa 30 x 18,5 cm

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4) Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie nr 5) Dotyczy Parametry Techniczne: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompatybilnego z urządzeniem, gotowego do użycia środka dezynfekującego i płynnego detergentu, z 5% nadtlutkiem wodoru i 10% alkoholem etylowym, o szerokim spektrum działania i certyfikowanej skuteczności bakteriobójczej, wirusobójczej, grzybobójczej, prątkobójczej oraz sporobójczej, testowaną w akredytowanych laboratoriach i zgodne z normami EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN ISO NFT 72-190, EN 14476 (badania aktywności biobójczej, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi, opublikowanymi przez CEN/TC 216, zostały wykonane przez centrum badawcze certyfikowane jako działające zgodnie z GLP), zawierającym w swoim składzie (100 g roztworu): nadtlutek wodoru 5,0 g; denaturowany alkohol etylowy 10,0 g; środki powierzchniowo czynne, stabilizatory i oczyszczoną wodę q.s do 100g, nie zawierającego chlorków, konfekcjonowanego w butelkach 1l lub 5l, spełniającym wymagania Zamawiającego względem kompatybilności materiałowej, bez zawartości kationów srebra, co nie wpływa na jego skuteczność?

Nanosrebro może wywoływać lekkie podrażnienie oczu i skóry, może także działać jak łagodny alergen na skórę. W narażeniu inhalacyjnym nanocząstki srebra działają głównie na płuca i wątrobę. Wykazano, że nanocząstki srebra mogą działać genotoksycznie na nasze komórki. Narażenie na nanocząstki srebra może działać neurotoksycznie i wpływać na funkcje poznawcze, wywołując zaburzenia pamięci krótkotrwałej i pamięci roboczej. Srebro w postaci koloidu ma ograniczony okres trwałości. Po dołączeniu do mieszaniny srebra koloidalnego nadtlutku wodoru, dzięki zjawisku oligodynamiki, następuje samokonserwacja preparatu. Srebro kumulujące się w organizmie powoduje srebrzycę (argyrię). Długotrwałe oddziaływanie może być jedną z przyczyn niepłodności. Może także powodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co pozwoli na jego większą konkurencyjność oraz wybór przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6) Czy Zamawiający dopuści urządzeniem kompatybilne ze środkiem oferowanym w punkcie powyżej, w którym czas ekspozycji (czas zamglawiania) wynosi maksymalnie 45 minut, natomiast czas przywrócenia pomieszczenia po zamglawianiu wynosi 30 minut?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7) Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywności wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego środka z urządzeniem? Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 8) Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze klinicznym (tj. obszar medyczny w zakresie – blok operacyjny, OIOM, Neonatologia, Hematologia itp.) i było to potwierdzone w rejestracji biobójczej?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 9) Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor)?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10) Czy Zamawiający dopuści środek o spektrum działania B,F,S,V- czas ekspozycji po zamglawieniu do 60 min. Po etapie wyrzutu środka rozpoczyna się etap utrzymania preparatu (czas kontaktu) dla osiągnięcia pełnego spektrum działania i wynosi on 120 minut.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11) Czy Zamawiający dopuści aby w wykazie przedmiotowych środków dowodowych były karty danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu bądź jego dystrybutora ze wskazaniem pozycji asortymentowej dla oferowanych artykułów.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12) Zadanie nr 2 Podkład wysokochłonny Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę podkładu o następujących parametrach:

- wymiary całkowite – 100 x 220 cm;
- wymiary warstwy chłonnej – 50 x 180 cm;
- minimum 5-warstwowy, o chłonności minimum 4.500 ml;
- udźwig – 150 kg / 1 minuta;
- nieprzemakalny;

- zawierający superabsorbent, dzięki czemu powierzchnia podkładu po absorpcji płynu staje się bardziej sucha?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13) Prosimy o modyfikację kryterium terminu dostaw dla Zadania nr 1 na najniżej oceniany 12 dni roboczych.

Odzież ochronna musi być każdorazowo odszywana względem zamówionych rozmiarów, kolorów oraz fasonów. Nie ma możliwości, by we wskazanym przez Zamawiającego terminie 3, 4 czy 5 dni roboczych przygotować zamówienie, tym bardziej takie, które ma być zrealizowane starannie i estetycznie.

Odpowiedź: zgodnie z wyjaśnieniami w Rozdziale XI SWZ – opis kryteriów można zaoferować termin 12 dniowy.

Pytanie nr 14) Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 odzież wykonaną z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliestr +/- 3% o gramaturze jak poniżej:

- tkanina biała 170 g/m²,

- tkanina kolorowa 125 – 128 g/m²?

Proponowana odzież dzięki dużej zawartości bawełny jest bardzo komfortowa i przewiewna. Niższa gramatura tkaniny powoduje zaś niższy tonaż prania a zatem i koszt usługi.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15) Czy Zamawiający dopuści Spodnie klasyczne z pozycji 1 proste, na gumkę z trokami do wiązania z przodu, z dwiema kieszeniami bocznymi, bez zamka i guzika?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16) Czy Zamawiający w ramach Zadania nr 1 odstąpi od wymogu zamieszczenia na metce wyrobu składu surowcowego tkaniny?

Skład nie jest wymagany wg przepisów, w związku z czym nie wszyscy producenci zamieszczają go na metkach.

Odpowiedzi: zamawiający odstępuje


Pytanie nr 17) Pytania dot. przedmiotu zamówienia: Zadanie 3, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw, który posiada dodatkowo przylepną taśmę medyczną w rozmiarze 5x90 cm oraz jest zapakowany w opakowanie typu blister ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 18) Zadanie 3, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- Serweta włókninowa FB 42g/m² w rozmiarze 75x75 cm – 1 sztuka
- Serweta SMS o gramaturze 35g/m² w rozmiarze 80cmx60cm z otworem o średnicy 8 cm z przylepcem – 1 sztuka
- Kompresy gazowe 7,5x7,5 cm – 7 sztuk
- Kleszczyki plastikowe pean 13 cm – 1 sztuka

Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

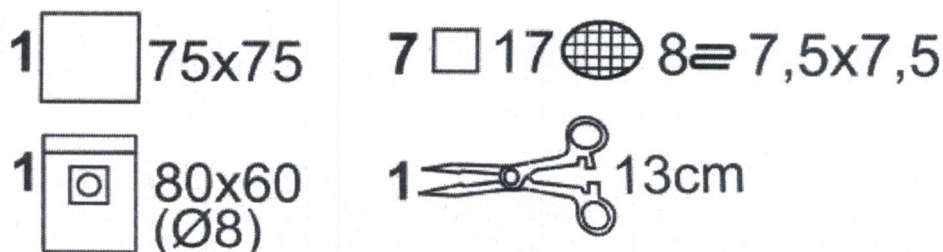


Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19) Zadanie 3, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw o składzie:

- Serweta włókninowa 80x60 cm – 1 sztuka
- Serwetka włókninowa 30x30 cm – 6 sztuk
- Kompres z gazy 17 nitek 8 warstw 10x10 cm – 20 sztuk

- Serweta z gazy 17nitkowa 4warstwowa z nitką RTG oraz tasiemką – 2 sztuki
- Zacisk plastikowy do pępowiny 5,5 cm – 1 sztuka
- Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m² 150x90cm – 1 sztuka
- Fartuch chirurgiczny wzmocniony rozmiar XL - 1 sztuka
- Podkład chłonny 60x60 cm -1 sztuka
- Podkład chłonny 60x90 cm – 1 sztuka

Zestaw zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. Zestaw posiada etykietę typu TAG składającą się z części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu; dwóch elementów – naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

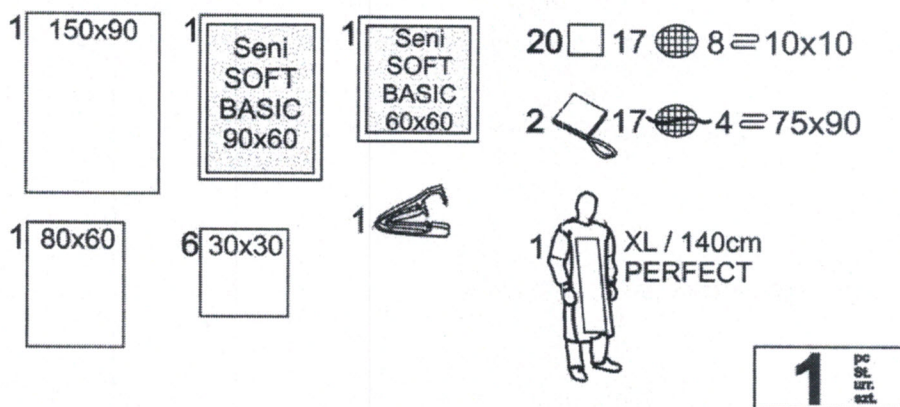

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20) Zadanie 3 poz.1,2,3 Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w torebkę papierowo-foliową zamiast typu TYVEC/folia?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia obrazkowo elementów wchodzących w skład zestawu i dopuści przedstawienie składu zestawu w formie opisowej

Odpowiedź: zamawiający odstępuje

Pytanie nr 22) Zadanie 3 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zestaw nieznacznie różniący się od wymagań Zamawiającego tj. (...) 1 serweta z otworem i przylepcem, rozmiar 45-75 x 75-90 [cm] otwór o średnicy 6x8cm (zamiast wymaganych 7-8 cm), gramatura min. 35 gr/m², (...) Pozostałe elementy i wymiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23) Zadanie 3 poz.3 Czy Zamawiający dopuści zestaw nieznacznie różniący się od wymagań Zamawiającego tj. (...) 2 szt. Serweta gazowa 70x45cm (zamiast wymaganych 90x75cm) 4W, tasiemka (...) pozostałe parametry i wymogi zestawu zgodnie z SWZ. (...) 1 szt serweta 2-warstwowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze min. 56g/m² rozm. 150x90cm (...) Pozostałe elementy i wymiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24) Dotyczy zad. 2 poz. 1 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, wysokochłonnego podkładu higienicznego na stół operacyjny, wykonanego z 2 scalonych powłok, mocnego nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia o wymiarach min. 200cm x 50cm (+/-2cm tolerancja). Warstwa chłonna lekko pikowana powodująca szybsze wchłanianie płynów, nie powodująca uszkodzeń skóry pacjenta. Chłonność min. 4L, wymiar całkowity 101cm x 229cm (+/-2cm). W zestawie z serwetą do repozycjonowania / transportu pacjenta o udźwigu 200kg i rozmiarze 101 x 152cm (+/-2cm).

Odpowiedź: Wymagaliśmy podkładu o udźwigu minimum 130 kg bez dodatkowej serwety (SWZ)

Pytanie nr 25) Dotyczy zadania nr 4: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez test chemiczny do kontroli mycia dodatkowej etykiety/metryczki, ponieważ sam test można oznaczyć danymi, a następnie umieścić w dokumentacji

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 26) Dotyczy zadania nr 4: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów skuteczności mycia i dezynfekcji zgodnych z normami dla testów mycia.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 27) Pakiet 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwodleżynowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo – brak możliwości tworzenia zagięć i pofałdowań pod pacjentem, samowygładzająca się. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem ułatwiającym rozprowadzanie wilgoci. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej (niebłyszczącej), teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

Parametry:

- chłonność 3750 – 4000 ml/m², (test potwierdzony badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym zg. ISO 9073-6), wskaźnik chłonności min. 2000 %
- wymiary: 102 x 230cm, rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami nieprzeziernego laminatu na całej szerokości podkładu.
- zgodne z ISO 9073-6: odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty,
- pakowana po 20 sztuk/karton

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28) Pakiet 8 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek składających się z:

Warstwa wewnętrzna: Polipropylen i polietylen spunbond, Biały

Warstwa zewnętrzna: Polipropylen Spunbond, Niebieski

Warstwa filtrująca: Polipropylen Meltblown, Biały

Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29) Pakiet 8 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek typu IIR składających się z 3 warstw- każda z nich wykonana z 100% polipropylenu, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30) Pakiet 8 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek w kolorze fioletowym pod warunkiem spełniania pozostałych warunków SWZ.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31) Zadanie nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32) Zadanie nr 2, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu bez możliwości przenoszenia pacjenta w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; powierzchnia lekko tłoczona, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33) Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m². Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ, serweta z poz. 1 jest za wąska

Pytanie nr 34) Pakiet 3, poz.2, 3- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu, w przypadku wezwania. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35) Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z przylepcem wokół otworu (dot. serwety 45-75 x 75-90 [cm] otwór o średnicy 7-8 cm)?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36) Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa

1 x serweta 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem przylepnym o śr. 7cm

10 x kompresy gazowe 13N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37) Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38) Pakiet 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z etykietą umieszczoną w widocznym miejscu opisującą skład zestawu wraz z rozmiarami w formie listy?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39) Pakiet 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 2-warstwową, polipropylenowo-polietylenową o gramaturze 60 g/m² rozm. 150cm x 100cm (w miejsce serwety o gramaturze 56g/m² rozm. 150x90cm)?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 40) Pakiet 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z etykietą umieszczoną w widocznym miejscu opisującą skład zestawu wraz z rozmiarami w formie listy?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41) Pakiet 3, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 42) Zadanie 8, pozycja 3 - Czy Zamawiający wymaga maski zgodnej z normą EN 1463 typ IIR, odporna na rozpryski, o skuteczności filtracji bakterii BFE 99,9%?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 43) Zadanie 8, pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski w opakowaniu a'25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: tak

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowie Świętokrzyskim
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Jerzy Szabla